

下水中の病原体遺伝子検出に

下水疫学調査(下水サーベイランス)用 リアルタイムPCRキット

◆ 製品一覧

製品名	容量	製品コード	価格(税別)
下水中の病原体遺伝子を検出			
SARS-CoV-2 Detection RT-qPCR Kit for Wastewater	100回	RC390A	¥152,000
Intestinal pathogenic bacteria Detection qPCR Kit for Wastewater 取寄	各100回	RC383A	★
Respiratory syncytial virus Detection RT-qPCR Kit for Wastewater 取寄	各100回	RC384A	★
Astrovirus/Adenovirus F Detection RT-qPCR Kit for Wastewater 取寄	100回	RC385A	★
Norovirus Detection RT-qPCR Kit for Wastewater 取寄	100回	RC387A	★
プロセスコントロール遺伝子を検出			
PMMoV Detection RT-qPCR Kit for Wastewater 取寄	100回	RC380A	★
Phi6 Detection RT-qPCR Kit for Wastewater 取寄	100回	RC381A	★

★ご注文条件の詳細についてはお問い合わせください。

本製品は、国立大学法人山梨大学国際流域環境研究センター 原本英司教授との共同研究を通じて製品化しました。

【特長】

- 各種ウイルス・細菌などの下水サーベイランス用検査キットをラインナップ
- 1ステップRT-qPCR法により高感度に検出
下水サンプル中の低コピーターゲットの検出に適しています。
- 本シリーズは同一の反応条件で使用可能
異なる複数の病原体遺伝子を同時に検出することが可能です。
- 反応時間は最短約50分
※Thermal Cycler Dice Real Time System IV with PC(製品コード TP1010)の場合
- PCR増幅産物のキャリーオーバーによる偽陽性を防止



<下水からの病原体遺伝子検出フロー>

採水

下水の濃縮

核酸精製

逆転写 & リアルタイムPCR解析

<コンポーネント例>

Norovirus Detection RT-qPCR Kit for Wastewater(製品コード RC387A)の場合

RT-qPCR試薬

- RT-qPCR Buffer
- Enzyme Mix
- NV (GI/GII) Primer/Probe
- RNase Free H₂O
- ROX Reference Dye II

コントロールDNA

- EASY Dilution (for Real Time PCR)
- Positive Control DNA (NV)

オールインワンキット!

RT-qPCRに必要なコンポーネントをセットにしており、核酸精製後、すぐにご利用いただけます。

下水疫学調査(下水サーベイランス)用 リアルタイムPCRキット

◆ 検出ターゲット一覧


検出対象	プローブ標識	反応条件	製品名	製品コード
新型コロナウイルス N遺伝子 (CDC N1, N2の同時検出)	Cy5	シングル	SARS-CoV-2 Detection RT-qPCR Kit for Wastewater	RC390A
トウガラシ微斑ウイルス(PMMoV)	FAM	マルチ		
Phi6ウイルス(Phi6)	HEX			
腸管出血性大腸菌(EHEC)	FAM	シングル (マルチ*)	Intestinal pathogenic bacteria Detection qPCR Kit for Wastewater	RC383A
サルモネラ属菌	Cy5			
赤痢菌	HEX			
RSウイルスA型	FAM	シングル (マルチ*)	Respiratory syncytial virus Detection RT-qPCR Kit for Wastewater	RC384A
RSウイルスB型	Cy5			
アストロウイルス	FAM	マルチ	Astrovirus/Adenovirus F Detection RT-qPCR Kit for Wastewater	RC385A
アデノウイルス F種	Cy5			
ノロウイルス GI	Cy5	マルチ	Norovirus Detection RT-qPCR Kit for Wastewater	RC387A
ノロウイルス GII	FAM			
トウガラシ微斑ウイルス(PMMoV)	FAM	シングル	PMMoV Detection RT-qPCR Kit for Wastewater	RC380A
Phi6ウイルス(Phi6)	HEX	シングル	Phi6 Detection RT-qPCR Kit for Wastewater	RC381A

* マルチプレックスで検出する場合は、弊社ウェブサイトで公開している各製品の技術情報をご参照ください。

◆ 実験例: 下水サンプルからのウイルス検出結果

【対象製品】Norovirus Detection RT-qPCR Kit for Wastewater (製品コード RC387A)

山梨県内の下水処理場において採取した、ノロウイルスGIおよびGII陽性の下水流入水9サンプルについて、ノロウイルスGIおよびGIIの検出を行った。反応はN=2で実施した。全てのサンプルからノロウイルスGIおよびGIIが検出された。

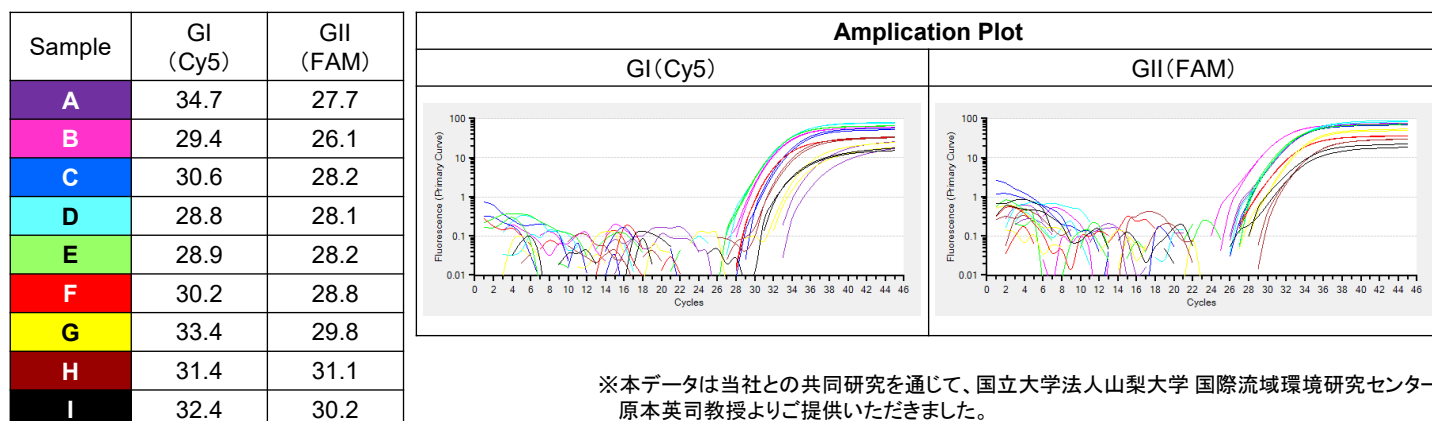

◆ 対象機器：リアルタイムPCR装置

- Thermal Cycler Dice Real Time System IV with PC (製品コード TP1010)
- Thermal Cycler Dice Real Time System III (Cy5) with PC (製品コード TP990)
- QuantStudio 5 Real-Time PCR System (Thermo Fisher Scientific 社)
- Applied Biosystems 7500 Fast Real-Time PCR System (Thermo Fisher Scientific 社)
- LightCycler 96 System/LightCycler 480 System II (Roche Diagnostics 社) *
- CFX96 Real-Time PCR Detection System (Bio-Rad 社)
- CFX96 Touch Deep Well Real-Time PCR Detection System (Bio-Rad 社) 等

* Respiratory syncytial virus Detection RT-qPCR Kit for Wastewater (製品コード RC384A) には使用できません。

・本チラシで紹介した製品はすべて研究用として販売しております。ヒト、動物への医療、臨床診断用には使用しないようご注意ください。また、食品、化粧品、家庭用品等として使用しないでください。・タカラバイオの承認を得ずに製品の再販・譲渡、再販・譲渡のための改変、商用製品の製造に使用することは禁止されています。

・本チラシに記載されている会社名および商品名などは、各社の商号、または登録済みもしくは未登録の商標であり、これらは各所有者に帰属します。

・ライセンスなどに関する最新の情報は弊社ウェブサイトをご覧ください。

・本チラシ記載の価格は2026年8月6日現在の希望小売価格です。価格に消費税は含まれておりません。

2026年8月作成N

タカラバイオ株式会社

営業部(東京) TEL 03-3271-8553 FAX 03-3271-7282
 営業部(本社) TEL 077-565-6969 FAX 077-565-6995
 テクニカルサポートライン TEL 077-565-6999 FAX 077-565-6995
 Website <https://www.takara-bio.co.jp>
 公式X @Takara_Bio_JP / https://x.com/Takara_Bio_JP

取扱店